

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży ochronnej jałowej oraz szpitalnych wyrobów papierowych.

Do dnia 01.12.2017r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pakiet 1

Czy Zamawiający ww. pozycji wymaga rękawic lateksowych czy też pozbawionych lateksu.

2. SIWZ pkt.11

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą (Załącznik nr 4).

3. Wzór umowy § 11 ust.1)

Prosimy o sprecyzowanie zmiany cen w przypadku wzrostu stawki podatku VAT. Czy w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegną ceny brutto (przy stałości cen netto) czy też ceny netto (przy stałości cen brutto)?

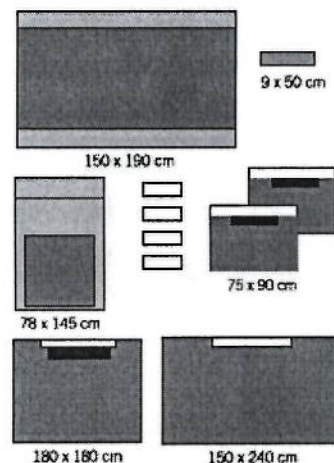
4. Wzór umowy § 11 ust.7)

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 18 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

5. – dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane zestawu uniwersalnego 2 warstwowego z łatą chłonną w składzie:

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
- 4 ręczniki do rąk
- 2 przyklejane serwety 2-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta średnia (2-warstwowa na całej powierzchni) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



44

6. – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane serwety 120x90cm spełniającej pozostałe wymagania stawiane w SIWZ?

7. – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane serwety 75x90cm spełniającej pozostałe wymagania stawiane w SIWZ?

8. Pakiet nr 4- pozycja nr 1








1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych do zabiegów dużych, mokrych, wysokiego ryzyka. Z materiału SMS o gramaturze min. 40g/m². Sterylnych, jednorazowego użytku, zgodnych z normą PN EN 13795, dla wymagań wysokich. Złożonych w sposób umożliwiający bezpieczną aplikację, wiązanych na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem, z zapięciem na bezpieczną taśmę regulującą rozmiar dekoltu umożliwiającą wielokrotne odpinanie i zapinanie, z mankietami o długości min. 7cm. Pakowanych podwójnie ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym, z włókniny SMS. W pakiecie minimum 2 ręczniki wysokochłonne o rozmiarze min. 30cm x 30cm długość fartuchów 155cm. Na opakowaniu zewnętrznym 2 etykiety dla potrzeb dokumentacji medycznej.- pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

9. Pakiet nr 4- pozycja nr 2

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych z zakładanymi połami, złożonych w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach. Troki umiejscowione w kartoniku, przy szyi zapięcie na bezpieczną taśmę regulującą rozmiar dekoltu umożliwiającą wielokrotne odpinanie i zapinanie. Wykonanych z materiału SMS o gramaturze min. 40g/m². Przeznaczonych do zabiegów generujących niewielką ilość płynów. Zgodnych z normą EN 13795. pakowanych podwójnie ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym, na zewnętrznym opakowaniu 2 etykiety samoprzylepna dla potrzeb dokumentacji medycznej. W zestawie 2 ręczniki rozmiar min. 30cm x 30cm. Długości fartuchów dla poszczególnych rozmiarów M- 115cm, L- 125cm, XL- 140cm, XXL- 155cm - pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

10. Pakiet nr 6– pozycja nr 1

1) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z 2-warstwowego materiału złożonego z warstwy barierowej nieprzemakalnej dla wilgoci ani bakterii oraz z hydrofilowej warstwy z polipropylenowej włókniny o bardzo niskim poziomie pylenia, który wykazuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie zarówno na sucho jak i na mokro, w którym taśma samoprzylepna ma wymiary 10cm x 50cm - pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

Zestaw uniwersalny i wzmocniony		6	938712	1
		zestawów		
Skład zestawu:				
	1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	140 x 190		
	1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145		
	1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	150 x 240		
	1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	200 x 175		
	2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym	75 x 90		
	1 taśma samoprzylepna	10 x 50		
	4 ręczniki celulozowe	30 x 33		

11. Pakiet 4 poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści fartuchy z ręcznikami 20 x 40 cm?
12. Pakiet 4 poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane z ręcznikami 20 x 40 cm?
13. Pakiet 4 poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach M, L, XL, XXL, o długości odpowiednio 130 cm, 140 cm, 150 cm, 165 cm?
14. Pakiet 6, poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw obłożeń chirurgicznych niedający refleksu z lamp operacyjnych, dopasowujący się do kształtu ciała, z klejem niealergizującym, z włókniny o niskim poziomie pylenia, odporny na przebicie i rozerwanie, zgodny z normą EN 13795 1-3z, jałowy, jednorazowego użytku, zawierający:
- 1 taśmę 9cm x 50cm,
 - 1 serwetę stołu Mayo wzmocnioną 80cm x 145cm,
 - 2 ręczniki do rąk,
 - 2 przyklejane serwety 75cm x 90cm z warstwą chłonna na całej powierzchni,
 - 1 przyklejaną serwetę średnią 170 cm x 180 cm, z warstwą chłonną na całej powierzchni,
 - 1 przyklejaną serwetę dużą 150 x 240cm z warstwą chłonna na całej powierzchni,
 - 1 serwetę na stół do instrumentarium 150cm x 190cm.
15. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
16. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pakiet 9): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

[Handwritten signature]

17. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 8, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.
18. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 8, pozycje: 1, 2, 3): złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w bariereki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Bariereki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnątrz skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcyjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje moczu do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.
19. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 8, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtkie minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

20. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 8, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek tzw. „oddychających” na całej powierzchni produktu, tj. od wewnątrz oraz na zewnątrz wkładu chłonnego oraz w partiach bocznych? Zastosowanie produktów oddychających na całej powierzchni, pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności po założeniu pieluchomajtki, przy zachowaniu maksymalnej ochrony przed niepożądanymi wyciekami. Wpływa to pozytywnie na zdrowie i komfort psychiczny pacjenta, jak również na czas pracy personelu poświęcony pielęgnacji ciała chorego, gdyż nie powstają podrażnienia skóry, pękanie, jak również odleżyny.
21. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 8, pozycja: 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.
22. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 8, pozycja: 1): pieluchomajtek dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 110cm?
23. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 8, pozycja: 2): pieluchomajtek dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 140cm?
24. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 8, pozycja: 3): pieluchomajtek dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 160cm?
25. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 8, pozycja: 3): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2400g?
26. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 8, pozycje: 2, 3): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2700g?
27. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 9, pozycja: 2): podkładów chłonnych w rozmiarze 60x90cm o chłonności co najmniej 1700g?
28. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 9, pozycja: 1): podkładów chłonnych w rozmiarze 60x60cm, o poziomie chłonności co najmniej 1200g?
29. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 8, pozycja: 4): złożenia oferty na majtki chłonne o poziomie chłonności co najmniej 1400g?
30. Pakiet 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne z powierzchnią zewnętrzną gładką?
31. Pakiet 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne z mankietem rolowanym bez opaski?

32. Pakiet 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne o grubości na palcu: 0,18mm+/-0,03mm?
33. Pakiet 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne pakowane podwójnie; opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowany papier?
34. Pakiet 4, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze 157cm (+/-3cm) bądź 138cm (+/-3cm), z mankietem o długości 7,5cm (+/-1cm), w pakiecie 2 ręczniki o wymiarach 30 x 30cm, na opakowaniu zewnętrznym 4 etykiety dla potrzeb dokumentacji?
35. Pakiet 4, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej 5 warstwowej włókniny typu SSMMS, rozmiary od M do XXL; długości – 124,128,138,157cm (+/-3cm), w pakiecie 2 ręczniki o wymiarach 30 x 30cm, na opakowaniu zewnętrznym 4 etykiety dla potrzeb dokumentacji?
36. Pakiet 4, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej 3 warstwowej włókniny typu SMS, rozmiary od M do XXL; długości – 124,128,138,157cm (+/-3cm), w pakiecie 2 ręczniki o wymiarach 30 x 30cm, na opakowaniu zewnętrznym 4 etykiety dla potrzeb dokumentacji
37. Pakiet 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m ²
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m ²
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m ²
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m ² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m ² i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m ² . Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

38. Pakiet 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający 1 taśmę w rozmiarze 10cm x 50cm, pozostałe części składowe zgodne z SIWZ?
39. Pakiet 7, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 120cm x 90cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
40. Pakiet 2, poz.1-4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych posiadających mankiety rolowane z opaską samoprzylepną, o grubości na palcu 0,190mm oraz długości min. 295mm, zapakowanych w foliowe opakowania zewnętrzne. Spełniający pozostałe wymagania siwz.
41. Pakiet 3, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o lepszym niższym poziomie AQL 0,65, o grubości na palcu 0,185mm, na dłoni 0,175mm, na mankiecie 0,160mm oraz długości min. 305mm – zapewniającą dobre przyleganie rękawicy do mankietu fartucha, zapewniając tym samym wyższe bezpieczeństwo użytkowników. Spełniający pozostałe wymagania siwz.
42. Pakiet 3, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic będących środkiem ochrony indywidualnej spełniających wszystkie wymogi Zamawiającego, ale będących ze względu na przeznaczenie środkiem ochrony indywidualnej (kategoria III) i posiadających jako środek ochrony indywidualnej wszystkie dokumenty dopuszczenia zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
43. Pakiet 4, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów z materiału Spunlace pakowanych podwójnie, ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny spunbond, w rozmiarze XXL – posiadającym długość 150 cm (+/- 2cm). Pozostałe parametry zgodne z siwz.
44. Pakiet 4, poz. 1
Czy Zamawiający będzie wymagał fartuchów posiadających gramaturę min. 68 g/m² w celu zapewnienia wyższego bezpieczeństwa użytkowników oraz zapobieganiu przed przeciekaniem fartucha.
45. Pakiet 4, poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów z materiału SMMMS o długości:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA
M	120cm
L	130cm
XL	140cm
XXL	150cm
XXXL	160cm
Tolerancja	+/- 2cm

46. Pakiet 6, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego posiadającego w serwetach o rozmiarze 75cm x 90cm większy obszar wzmocnienia tj. 45x60cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz.
47. Pakiet 7, poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety przyklepnej w rozmiarze 100 x 150cm.
48. Pakiet 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych sterylnych o powierzchni mikroteksturowanej.
49. Pakiet 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co ma na myśli wymagając rękawicy niealergiczej, czy Zamawiający rozumie przez to zawartość protein lateksowych <30 ug/g rękawicy (potwierdzona badaniami niezależnego laboratorium).
50. Pakiet 4, pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha pakowanego w podwójne opakowanie: torba papierowo-foliowa i wewnętrzne z włókniny (owinięcie), zestaw zawiera 2 ręczniki w rozmiarze 39x30 cm, na opakowaniu min. 2 etykiety do dokumentacji, pozostałe zgodnie z SIWZ.
51. Pakiet 4, pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny typu SMS, ręczniki 40 x 40 cm pakowane oddzielnie, fartuch dostępny w długościach 115 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm, 150cm, pozostałe zgodnie z SIWZ.
52. Pakiet 4, pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny typu SMMMS, ręczniki 39x30 cm, fartuch dostępny w długościach 115 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm, 150cm, 160 cm, opakowanie zawiera min. 2 etykiety do dokumentacji, pozostałe zgodnie z SIWZ.

53. Pakiet 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy oddychających i nieprzepuszczalnych z rękawków, z mankietem, testowanych w na leki do chemioterapii według ASTM F739-99a (min. Dacarbazine, Carmustine, Paclitaxel, Cyclophosphamide (Cytosan), 5- Fluorouracil, Cisplatin), pakowanych a'2 sztuki.
54. Pakiet 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu obłóżeń z osłoną na stolik Mayo w rozmiarze 80x142 cm i osłoną na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 152x190 cm w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.
55. Pakiet 7, pozycja 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 150x90 cm w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ.
56. Dotyczy: pakietu nr 7 pozycja 2.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety sterylnej o rozmiarze 90x90 cm?
Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
57. Dotyczy pakietu nr 6 pozycja 1.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego w składzie:
- 1 taśmę 9cm x 51cm
- 1 serwetę stołu Mayo wzmocnioną 75cm x 150cm wzmocniona na całej długości,
- 4 ręczniki do rąk,
- 2 przyklejane serwety 75cm x 90cm z łata chłonna 20cm x 50cm,
- 1 przyklejaną serwetę średnią 175cm x 175cm, z łata chłonna 20cm x 50cm,
- 1 przyklejaną serwetę dużą 150cm x 240cm z łata chłonna 20cm x 50cm,
- 1 serwetę na stół do instrumentarium 150cm x 200cm.
Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Ad. 1 Zamawiający - zgodnie z treścią SIWZ - dopuszcza możliwość zaoferowania zarówno rękawic lateksowych jak i pozbawionych lateksu.
- Ad. 2 Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, przedstawi stosowne oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 11 – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
- Ad. 3 Zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, opublikowanej po terminie składania ofert uzależniona jest od wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający nie precyzuje czy będzie to cena netto, czy brutto. Zależne to będzie od okoliczności konkretnego przypadku i służyć ma pokryciu zwiększonych kosztów Wykonawcy wywołanych wzrostem stawki podatku VAT.

- Ad. 4 Zmiana umowy dotycząca wydłużenia okresu obowiązywania umowy wymaga dokonania jej zmiany w formie pisemnej. Nie następuje ona automatycznie. Zmiana umowy wymaga zgody Wykonawcy.
- Ad. 5 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.
- Ad. 6 i 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanych wymiarach i wymaga – parametrów zgodnych z SIWZ.
- Ad. 8 - 12 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.
- Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanych wymiarach i wymaga – parametrów zgodnych z SIWZ.
- Ad. 14 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.
- Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.
- Ad. 16 Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia proponowanego dokumentu, który będzie traktował jako opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wymagania określone w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia.
- Ad. 17 Zamawiający nie określa w SIWZ parametrów chłonnych (parametr ten nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamówienia).
- Ad. 18 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia (pieluchomajtki dla dorosłych) z barierkami wewnętrznymi skierowanymi zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz.
- Ad. 19 Zamawiający nie wymaga zaoferowania pieluchomajtek dla dorosłych posiadających ściągacz taliowy.
- Ad. 20 Zamawiający nie wymaga zaoferowania pieluchomajtek tzw. oddychających na całej powierzchni.
- Ad. 21 - 24 Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia w rozmiarze określonym w SIWZ.
- Ad. 25 - 29 Zamawiający nie określa wymaganych parametrów chłonnych dla oferowanego przedmiotu zamówienia.
- Ad. 30 - 32 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach i wymaga – produktu zgodnie z SIWZ.
- Ad. 33 i 34 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.
- Ad. 35 i 36 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach i wymaga – produktu zgodnie z SIWZ.
- Ad. 37 - 39 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.

- Ad. 40 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach i wymaga – produktu zgodnie z SIWZ.
- Ad. 41 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.
- Ad. 42 - 45 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach i wymaga – produktu zgodnie z SIWZ.
- Ad. 46 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.
- Ad. 47 - 48 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach i wymaga – produktu zgodnie z SIWZ.
- Ad. 49 Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SIWZ.
- Ad. 50 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.
- Ad. 51 i 52 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach i wymaga – produktu zgodnie z SIWZ.
- Ad. 53 i 54 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.
- Ad. 55 i 56 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach i wymaga – produktu zgodnie z SIWZ.
- Ad. 57 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanych parametrach.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia) w zakresie dopuszczenia możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia, o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodując konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

mgr Mariola Brodowska



