

Bydgoszcz, dnia 30.12.2016r.

A.ZP.261.60.2016

## Do Wykonawców

**Dotyczy:** procedury konkursowej na dostawę materiałów do sterylizacji.

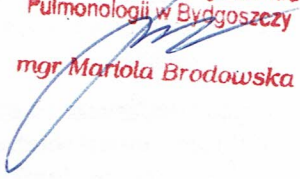
Do dnia 29.12.2016 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści Zaproszenia do złożenia oferty:

1. Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści opakowania papierowo-foliowe skonstruowane z folii zgrzewalnej w temperaturze 165°C - 200°C?
2. Pakiet 5: Czy Zamawiający wymaga wskaźników typu 6?
3. Pakiet 7: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki o parametrach 121°C-9 min, 134°C-3 min.?
4. Pakiet 10 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści wskaźnik kontrolujący mycie w jednej płaszczyźnie?
5. Pakiet 15 i 16: Czy Zamawiający dopuści podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych, gdzie cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie będzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze podczas realizacji umowy?
6. Pakiet 19: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki wykrywania pozostałości białkowych nie wymagające zastosowania inkubatora?
7. **Pakiet nr 2**  
Czy zamawiający dopuszcza torebki o wymiarach:  
200 mm x 400 mm zamiast torebek 205 mm x 400 mm  
270 mm x 450 mm zamiast torebek 270 mm x 440 mm  
320 mm x 500 mm zamiast torebek 300 mm x 500 mm  
420 mm x 610 mm zamiast torebek 420 mm x 600 mm
8. **Pakiet nr 2**  
Czy zamawiający dopuszcza rękawy papierowo foliowe zawinięte folią do wewnątrz?
9. **Pakiet nr 2**  
Czy zamawiający dopuszcza rękaw papierowo foliowy z fałda o wymiarze 380 mm x 80 mm zamiast rękawa 300 mm x 80 mm?
10. **Pakiet nr 5**  
Czy zamawiający dopuszcza Zintegrowany test paskowy do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parowej wszystkich kombinacji parametrów krytycznych (134°C- 3,5 min., 121°C-15 min.)?

### Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Ad.1 Pakiet 2 - Zamawiający dopuści opakowania papierowo -foliowe zgrzewalne w temp. 165° - 200°C pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków.
- Ad.2 Pakiet 5 – Zamawiający wymaga testu zintegrowanego, ale dopuści test klasy wyższej pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

- Ad.3 Pakiet 7 - Wszystkie wymagania stawiane testom zostały ściśle określone w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia, Zamawiający nie przewiduje zmian, zatem podtrzymuje parametry 121° - 20 min. 134° - 7 min i nie dopuszcza parametrów 121° - 9 min. 134° - 3 min.
- Ad.4 Pakiet 10 – Zamawiający wymaga czteropłaszczyznowego sprawdzianu kontroli skuteczności mycia zgodnie z zapisami zawartymi w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia, nie dopuszcza wskaźnika jednopłaszczyznowego.
- Ad.5 Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Ad.6 Pakiet 19 - Zgodnie z zapisem zawartym w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga, aby test był kompatybilny z posiadanym inkubatorem Clean Trace, zatem nie dopuszcza innego nie spełniającego wymagania.
- Ad.7 i 9 Wymagania dotyczące rozmiarów opakowań papierowo – foliowych zostały ściśle określone w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia, są optymalne do potrzeb Zamawiającego. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dopuszcza się opakowania w rozmiarach max. + 10 mm w stosunku do podanych w tabeli Formularza cenowego/ Przedmiot zamówienia. Zatem torebek, których rozmiary nie mieszczą się w ustalonych przez Zamawiającego granicach, Zamawiający nie dopuszcza.
- Ad.8 Zamawiający podtrzymuje sposób nawinięcia rękawa folią na zewnątrz. Ze względów higienicznych, zgodnie z zapisami w Formularzu cenowym /Przedmiot zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza rękawów nawiniętych folią do wewnątrz.
- Ad.10 Wszystkie wymagania stawiane testom zostały ściśle określone w Formularzu cenowym /Przedmiot zamówienia i Zamawiający nie przewiduje zmian, zatem podtrzymuje parametry - 121° - 20 min. 134° - 7 min i nie dopuszcza parametrów 121° - 15min. 134° - 3,5 min.

DYREKTOR  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum  
Pulmonologii w Bydgoszczy  
  
mgr Martola Brodawska